LECIGON®

(levodopa 20 mg/ml, karbidopa 5 mg/ml, entakapon 20 mg/ml)

Kortguide för vårdpersonal

För fullständig instruktion se bruksanvisning/bipacksedel

Uppdaterad version av Crono LECIG pump

nordic INFUcare

www.infucare.com

Crono® LECIG pump

(uppdaterad version)

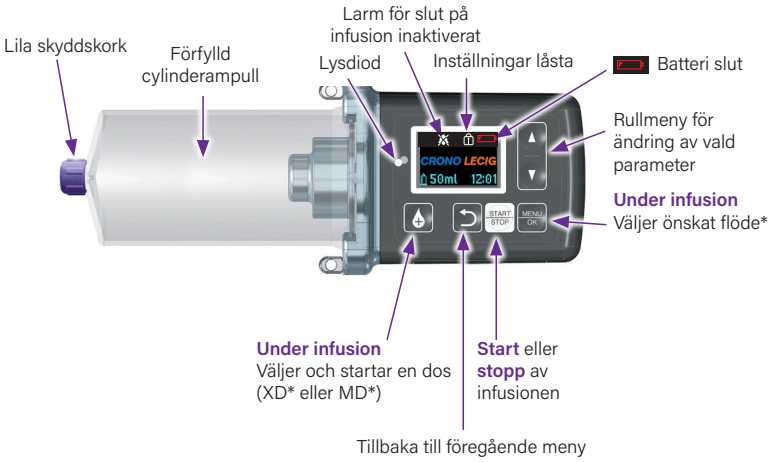

Tillverkare:
Crono® LECIG pump: CANÈ, S.p.A. Italia. www.canespa.it

CE 0476

Pumplarm

I händelse av pumplarm visas en felkod i displayen, och lysdioden tänds. För att pumpen ska fungera optimalt behöver den rengöras. För åtgärder och fullständig information se bruksanvisning.

KOD: OCCL
Orsak: Stopp i PEG/J slang.
Korrigerande åtgärd: Kontrollera att PEG slang inte är vikt/klämd, se "Åtgärda ocklusioner".

KOD: Batt
Orsak: Batteri urladdat.
Korrigerande åtgärd: Byt batteri, se "byta batteri".

PEG/J

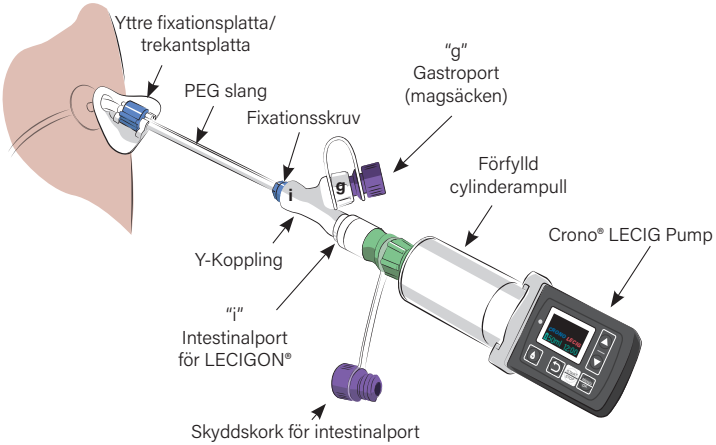

LECIGON®

- **Förvaras i kylskåp (2°C– 8°C).**
- **Ljuskänslig.**
- **För engångsbruk** och ska inte användas i mer än 24 timmar, även om det finns läkemedel kvar.
- **Ampullen kan användas i 24 timmar** efter att den tagits ur kylskåpet.

Vid resa finns några saker patienten kan tänka på:

- Ta med tabletter för sin Parkinson om något oförutsägbart händer.
- Förvara läkemedlet i en kylväska som handbagage (USB och/eller elsladd) läs mer: **Transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/Medicin/**
- Lånepump (vid utlandsresa)
- Parkinson passport finns att ladda ner: **parkinsonseurope.org/the-parkinsons-passport**
- Pumpen är inte vattentät och ska kopplas bort vid dusch och bad.
- Bad i hav / pool går bra så länge stomat är läkt.

Starta pump med kontinuerlig dos (F1)

- Anslut ny cylinderampull till pump eller fortsätt med befintlig (max i upp till 24 tim).
- Koppla ampull till intestinalport **(i)**.

- **Tryck och håll kvar** - pump startar.

Aktivera morgondos

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **Tryck och håll kvar.**

- **Tryck pil ner,** gulmärk morgondos.

- **Tryck igen och håll kvar**
  - morgondos administreras.

Aktivera extrados

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **Tryck och håll kvar.**
- Extrados gulmärkt.

- **Tryck och håll kvar** - extrados administreras.

Byte mellan programmerade flöden

(om fler finns ordinerade, F1-F3)

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- När pumpen är igång, tryck på **OK.**

- **Välj** önskat flöde.

- Bekräfta, tryck **OK.**

Stoppa/ pausa pump

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **Tryck och håll kvar.**

- För att stoppa infusion, bekräfta, tryck **MENU/OK.**
- **STOP** visas.
- Skruva av ampull från intestinalport **(i)** (utan att vrida PEG/J).

Avsluta infusion
Dra tillbaka kolvstång

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **Tryck och håll kvar.**
- För att stoppa infusion, bekräfta, tryck **MENU/OK.**
- **STOP** visas.
- Skruva av ampull från intestinalport **(i)** (utan att vrida PEG/J).

- **Tryck och håll kvar.**

- **Välj med pil** Slut/ Dra tillbaka kolvstång. Bekräfta med **Meny OK** knapp.

- Välj JA med pil. (uppdaterad version)

Ampullen tas bort när tryckkolven gått tillbaka helt. Tar ca 4-6 min.

Ändra doser/spärrtider/larmljud

För att ändra inställningar ska pumpen visa STOP eller OFF och vara upplåst.

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **Tryck och håll kvar.**
- Inställningar gulmärkta.

- Tryck **OK**.

- **Välj** önskad programmering.

- Tryck **OK**.

- **Ändra** programmering.

- Tryck **OK**.

- Tillbaka till STOP eller tryck EXIT.

Hitta programmerade doser

Pumpen måste vara igång för att du ska kunna se programmerade doser

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- **F1** Kontinuerliga flödet blir synligt i fönstret.

- **Tryck och håll kvar.**
  Extrados + Morgondos synliga

- **Tryck OK och håll kvar. F2** och **F3** blir synliga (om fler än ett flöde är programmerat).

Låsa/Låsa upp pump

Aktivera display genom att trycka på **valfri knapp**.

- Tryck och håll kvar.

- Tryck, välj reserverad.

- Tryck **OK**. Ange kod med pilarna.
  Tryck **OK** mellan varje siffra.

- Välj **blockera inställningar** och tryck **OK.**

- Välj med pilarna:
  - **ON** för att låsa inställningarna.
  - **OFF** för att låsa upp inställningarna.

- Tryck **OK.**

- Tillbaka till startskärm, **tryck 2ggr**.

- **Låssymbol** visas när inställningar är låsta.

Daglig skötsel av PEG/J



1. Dra upp dricksvatten i en ENFit 20 ml spruta.

2. Vrid på sprutan till intestinalporten **"i"**.

3. Spola med dricksvattnet. I början kan det vara trögt.



4. Fyll sprutan igen med 20 ml dricksvatten, sätt sprutan till gastroporten **"g"** och spola.

Stomavård PEG/J

Görs alltid i upprätt position. Minst 2ggr per vecka gärna i samband med dusch.



1. Öppna låset på trekantsplattan och lösgör PEG.



2. För trekantsplattan ut från stomat. Stomat, trekantsplattan och PEG tvättas rent med tvål och vatten.

3. För PEG slang rakt in i stomat 4-5cm (vrid ej). Dra försiktigt slangen tillbaka. Torka torrt.



4. Kontrollera avståndet mellan hud och trekantsplatta, bör vara ca 5 mm.



5. Fixera PEG på trekantsplattan och stäng låset.

Kontrollera avståndet mellan huden och trekantsplattan igen. Mindre rodnad runt stomat av och till är helt normalt. Tecken på infektion kan vara rodnad större än 5 mm.

Kopplingsbyte PEG/J

Y- koppling finns i olika storlekar, säkerställ storlek innan kopplings-byte utförs. För instruktionsfilm, se medicininstruktioner.se

1. Fixera intestinalsonden med hjälp av peang på PEG.



2. Klipp av gammal koppling, kasseras.



3. Fixera intestinalsond innan peang på PEG öppnas. Drag ut intestinalsonden ca 8 cm.

4. Fixera intestinalsond igen.



5. Trä på fixeringsskruv. Torka PEG torr med kompress, innan steg 6.



6. Trä på Y-koppling tills koppling och PEG-slang möts.



7. Fixera skruv mot Y-koppling tills vita skruvnyckeln lossnar, avlägsna denna. Kontrollera att PEG sitter fast.



8. Trä klick-koppling på intestinalsond. Vänta med att fixera.

9. Torka intestinalsonden torr med kompress. Trä den sedan hela vägen upp på ENFit kopplingens metallnippel



10. Skruva ihop klick och ENFit kopplingen till låst läge.

11. Tryck ihop klick och Y-koppling tills du hör ett "klick". Se till att de räfflade markeringarna placeras bakom gastroport **"g"** enligt bild.











PEG-slang släpper från fixationsskruv

1. Skruva loss skruven från Y-kopplingen.

2. För skruven över slangen.

3. Torka torrt med kompress vid änden på slangen. För den sedan hela vägen upp på Y-kopplingen.

4. Skruva ihop Y-kopplingen med fixationsskruven. Kontrollera att PEG-slangen sitter fast, annars bör hela kopplingen bytas ut.



Intestinalsond åkt ut en bit

Intestinalsond, är fixerad på klick-kopplingen. Kopplingen har räfflade sidor. När dessa trycks ihop går det att öppna/stänga kopplingen. För sonden mot Y-kopplingen och tryck ihop. Kontrollera att den fäster annars byt ut hela kopplingen. Vid svårighet att föra tillbaka sonden fukta med vatten/matolja och spola med dricks-vatten, samtidigt som sonden matas in. Ett tydligt ”klick” ska höras när Y-kopplingen och klick kopplingen kopplas ihop.

Parkinson Support

Tel: 020 22 55 20
www.medicininstruktioner.se

Lecigon® (20 mg/ml levodopa, 5 mg/ml karbidopa, 20 mg/ml entakapon), intestinal gel. Rx, F. N04BA03, VNR 525575. SmPC 2023-10-27 ,
Indikation: Behandling av levodopa-känslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga orala kombinationer av läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte gett tillfredsställande resultat. Varningar och försiktighet: Rekommenderas inte för behandling av läkemedelsinducerade extrapyramidala reaktioner. Ska administreras med försiktighet vid ischemisk hjärtsjukdom, allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller lungsjukdom, bronkialastma, njur- eller leversjukdom, endokrin sjukdom, tidigare magsår eller tidigare kramper. Noggrann övervakning med hänsyn till utveckling av psykiska förändringar och depressioner. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel, andra läkemedel som kan ge ortostatisk hypotension, och vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter ska följas noga när dosen minskas eller behandlingen avbryts abrupt, och patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Regelbunden utvärdering av lever- och njurfunktion, blodbild och kardiovaskulära funktioner rekommenderas vid längre tids behandling. Komplikationer som besoarbildning kan vara en startpunkt för tarmobstruktion eller invagination med magsmärtor. En plötslig eller gradvis försämring av bradykinesi kan tyda på ett stopp i sondsystemet. Försiktighet ska iakttas för kraftig viktminskning (särskilt med diarré), progressiv anorexi och asteni. Vid misstanke om missbruk av läkemedlet finns en låsfunktion i den pump som används tillsammans med Lecigon. Polyneuropati har rapporterats hos patienter som behandlats med Duodopa (levodopa/karbidopa intestinal gel). Innan behandling med Lecigon påbörjas, utvärdera patienterna gällande anamnes eller tecken på polyneuropati och kända riskfaktorer, och regelbundet därefter. **Mycket vanliga biverkninga**r är urinvägsinfektion, viktminskning, ångest, depression, sömnlöshet, dyskinesi, Parkinsons sjukdom/förvärrad parkinson-ism (t.ex. bradykinesi), ortostatisk hypotoni, illamående, förstoppning, diarré, smärta i muskler och fall. Procedur-och sondrelaterade biverkningar är post-operativa sårinfektioner, magsmärta, komplikationer vid insättande av sond, stoma-läckage, smärta, samt reaktion vid området där sonden satts in. Får ej användas vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, trångvinkelglaukom, svår hjärtinsufficiens, allvarlig hjärtarytmi, akut stroke, svår leverfunktionsnedsättning, administrering av icke-selektiva MAO-hämmare eller selektiva MAO-hämmare typ A, tillstånd där adrenergika är kontraindicerade, malignt neuroleptikasyndrom (MNS) och icke-traumatisk rabdomyolys, samt misstänkta odiagnostiserade hudlesioner eller tidigare melanom. För fullständig information och priser se www.fass.se. Innehavare av godkännande för försäljning: LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala. Distributör: NordicInfu Care AB www.infucare.se.

LECI.SE.079-02-DEC2025

nordic INFUcare
www.infucare.com

Distr. NordicInfu Care AB,
Gustavslundsvägen 12, Alvik, Sverige
Tel: +46 8 601 24 40